

Hollister Ostomy. **Omdat peristomale huid belangrijk is.**

CeraPlus huidplaten
met Remois-technologie¹


De CeraPlus huidplaten bevatten ceramide, lipide moleculen die van nature aanwezig zijn in de huid en de peristomale huid gezond houden. Deze huidplaten worden gebruikt in combinatie met Conform 2 zakjes, zodat patiënten kunnen blijven genieten van de exclusieve eigenschappen zoals de vlottende ring, de AF300 filter, de geïntegreerde Lock ‘n Roll sluiting en het unieke kraantje van het urostomazakje.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw Hollister Ostomy Product Specialist.



Vlakke huidplaten
5 stuks / doos

Code	MM	Ring	Referentie	APB-code	RIZIV-lijst	RIZIV-code
	13-30mm	45mm	14500	3289-840	640371 ^(colo-ileo) - 640872 ^(uro)	904004000636 ^(colo-ileo) - 904020000572 ^(uro)
	13-40mm	55mm	15500	3289-857	640371 ^(colo-ileo) - 640872 ^(uro)	904004000636 ^(colo-ileo) - 904020000572 ^(uro)
	13-55mm	70mm	17500	3289-865	640371 ^(colo-ileo) - 640872 ^(uro)	904004000636 ^(colo-ileo) - 904020000572 ^(uro)



Convexe huidplaten²
5 stuks / doos


Code	MM	Ring	Referentie	APB-code	RIZIV-lijst	RIZIV-code
	13-25mm	45mm	14600	3289-873	640791	90404000123
	13-38mm	55mm	15600	3289-907	640791	90404000123
	13-51mm	70mm	17600	3289-931	640791	90404000123

¹Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd.
² Bestaat eveneens in voorgeknipte versie (voor meer info, raadpleeg onze catalogus)

Het Hollister logo, AF300, CeraPlus, Lock ‘n Roll, Conform 2 en “Hollister Ostomy. Details matter.” zijn een handelsmerk van Hollister Incorporated.
© 2016 Hollister Incorporated.
OST16N106



Attention to Detail. Attention to Life.




CeraPlus
Huidplaten *met Remois-technologie**

Hollister Belgium
Chaussée des Collines 52
1300 Wavre
010 23 04 77
belgium.orders@hollister.com


www.hollister.be

Achtergrondsheets:


Welk type stoma werd geëvalueerd?

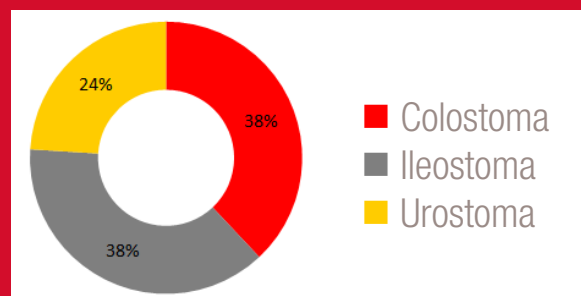


Welk type materiaal werd geëvalueerd?

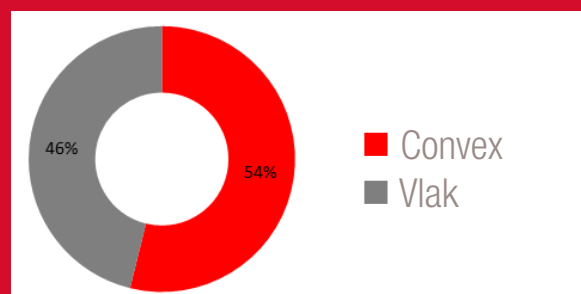

Was er voor de evaluatie een peristomaal huidprobleem?

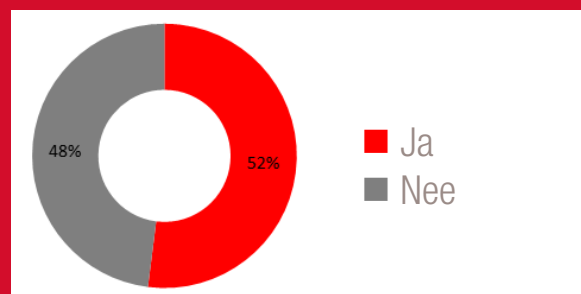

Was er een aandoening die een risico vormde voor de peristomale huid?

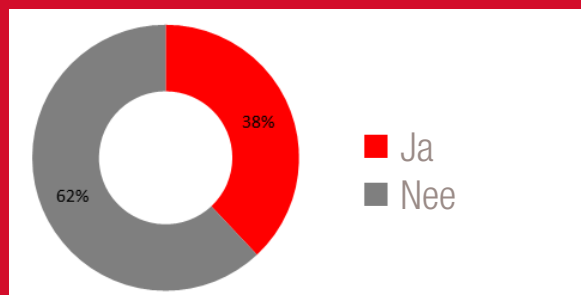


Dit is uw mening* over Conform 2 CeraPlus




■ Tevreden
■ Neutraal
■ Niet tevreden


Algemene tevredenheid

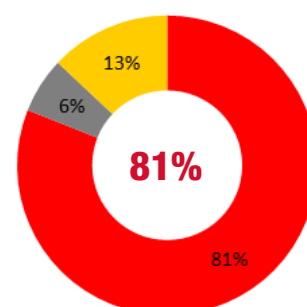


Gebruiksgemak/aanbrengen

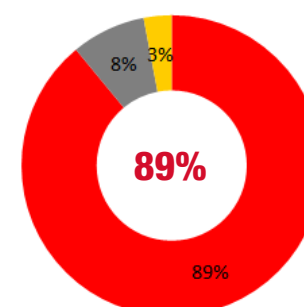


Kleefkracht

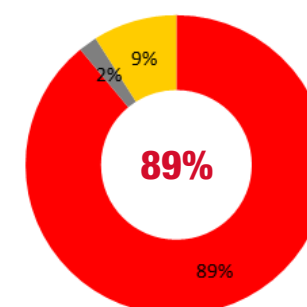

Verwijderen

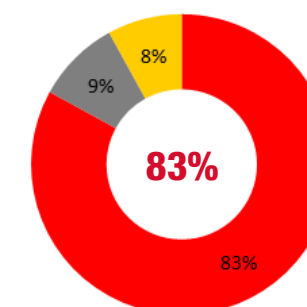


Draagtijd

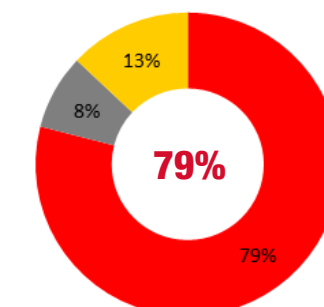


■ Vermindering
■ Geen verandering
■ Toename


Vermindering topische medicatie

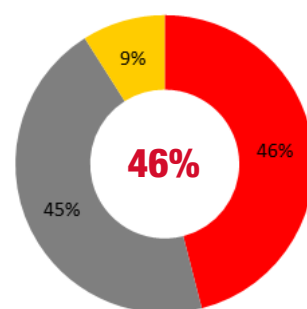

Minder frequente wissels

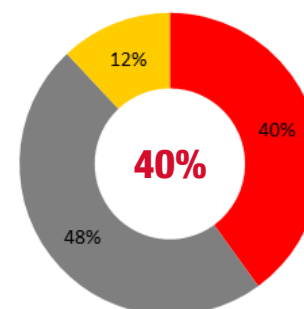


Minder hulpmiddelen

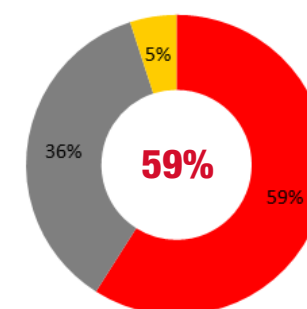

■ Verbeterd
■ Onveranderd
■ Erger

Verbetering van de peristomale huid

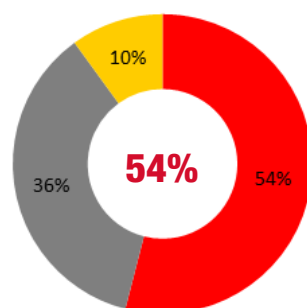

Het gebruik van Conform 2 CeraPlus huidplaten

- ✓ heeft een positieve invloed op de gezondheid van de peristomale huid.
- ✓ draagt actief bij tot het voorkomen en genezen van huidproblemen, dankzij de aanwezigheid van ceramide (lichaamseigen lipide moleculen).
- ✓ **verlengt de draagtijd.** De kleefkracht en extreme soepelheid van de huidplaat dragen bij tot het verminderen van lekkage.
- ✓ reduceert het gebruik van extra hulpmiddelen (barrièrefilm, poeder,...).

*Eigen onderzoek Hollister Belgium 2015

